

FWD（重錘落下式たわみ測定装置）検定施設

FWD [Falling Weight Deflectometer] Calibration Center

FWD 検定施設とは


舗装の支持力を評価する非破壊試験装置として FWD (Falling Weight Deflectometer : 重錘落下式たわみ測定装置) があります。FWD は、衝撃荷重を舗装路面に与えることで変形する路面の形状を測定する装置で、衝撃荷重を測定する荷重計とたわみ量を測定する変位計、それらのデータを取り込むインターフェイス等から成っています。

その主たる装置である「荷重計」と「変位計」を較正・検定する施設が、『FWD 検定施設』です。




FWD は付図1のような構成になっています。

衝撃荷重を舗装路面に作用させた時に、複数個の変位計で路面のたわみ量を測定でき、それによってたわみの形状がわかります。たわみの形状がわかることで、舗装全体としての支持力だけでなく、舗装を構成する各層の状態も把握できるようになります。その概念は付図2のとおりです。このようにして舗装構造が評価できることから、舗装の性能評価法の一つとして、疲労破壊輪数の推定（構造的な寿命の予測）にも用いられるようになりました。

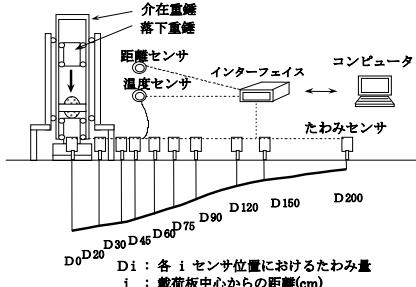

付図1 FWD の構成例（複重錘式の例）

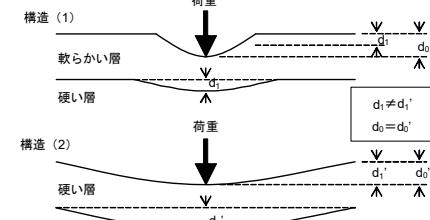

付図2 たわみ量と形状による舗装構造評価の概念

施設の概要

施設は、2台のFWDが同時に入れるように、奥行き約14.5m、幅約5.5m、高さ約5.5mとなっています。（図1参照）また、測定時の室内温度を20°C程度に保てるような空調設備も備えています。

施設の内部は写真1のようになっています。荷重計較正用の舗装（約1m四方）が中央部にあり、それを挟んで変位計較正用のアスファルト舗装（約4.5m四方）とコンクリート舗装（約4.5m四方）があります。

変位計較正用舗装の構造は、図2のようになっており、荷重計較正用舗装は、長さ12mの支持杭の上に約1mの厚さのコンクリートが打設されています。


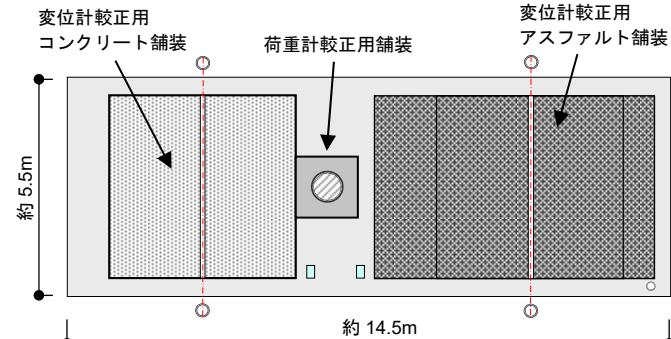


図1 FWD 検定施設内部の平面図



写真1 FWD 検定施設内部

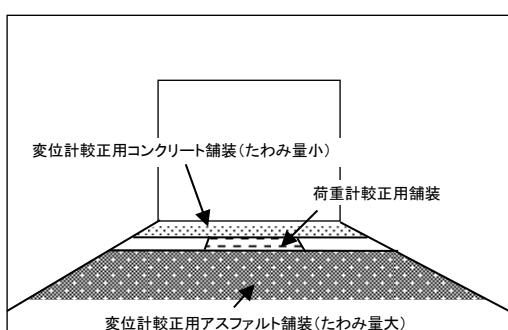

アスファルト舗装		コンクリート舗装	
表層	50	コンクリート版	180
基層	50	切込碎石	220
粒調碎石	150		
切込碎石	250		
砂層	700		

※数値の単位：mm

図2 変位計較正用舗装の構造



国立研究開発法人 土木研究所
道路技術研究グループ 舗装チーム

〒305-8516 つくば市南原 1-6
(029) 879-6789
URL: <http://www.pwri.go.jp/>

FWD（重錘落下式たわみ測定装置）検定施設

FWD [Falling Weight Deflectometer] Calibration Center

較正・検定の方法

① 荷重計の較正・検定

50kN のロードセルを 3 個配置し、受圧板と一体化させたシステム上に FWD の荷重を載荷して、ロードセルと FWD の荷重計の測定値を比較します。(写真2, 図3参照)



写真2 荷重計較正用ロードセル

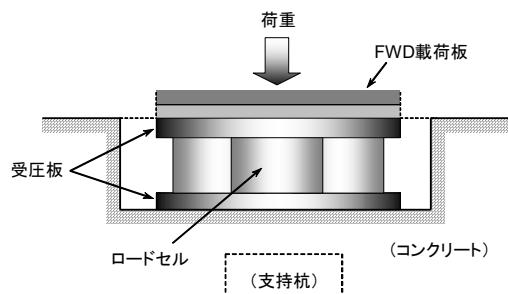


図3 荷重計の較正方法の概念

② 変位計の較正・検定

各較正用舗装の中央部の横方向に溝（トレンチ）が設置されていて、屋外の地中に打ち込んだ支持杭で両端を固定したPC鋼棒を不動点として、そこに取り付けたギャップセンサーと FWD の変位計の測定値を比較します。

(写真3, 4, 図4, 5参照)



写真3 屋外の支持杭と鋼管



写真4 舗装の溝（トレンチ）

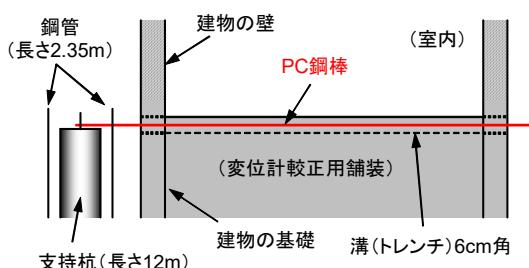


図4 PC鋼棒の固定方法

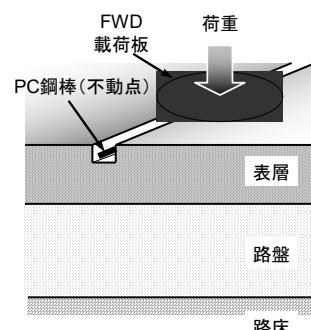


図5 変位計の較正方法の概念


なお、FWD 載荷時の振動が支持杭に伝わらないよう、支持杭の外側に鋼管を打ち込んでいます。

③ 較正・検定のイメージ

図6に示すように、FWD のたわみとギャップセンサーの変位の測定値は、原点を通る直線で近似できます。したがって、例えば載荷荷重を 3 通り変化させてたわみを測定すれば、図のような関係が得られ較正できることになります。

舗装チームから一言

本施設の活用により、FWD による舗装の構造評価への信頼性がより一層向上することを期待するとともに、舗装の構造状態が的確に診断されることで、効果的・効率的な舗装管理にも大いに貢献できるものと考えています。

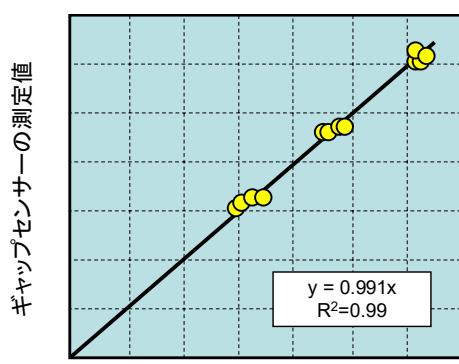

FWDのたわみ測定値

図6 変位計の較正結果のイメージ



国立研究開発法人 土木研究所
道路技術研究グループ 舗装チーム

〒305-8516 つくば市南原 1-6
(029) 879-6789
URL: <http://www.pwri.go.jp/>